


5. 機器室

2010年10月




2011年3月

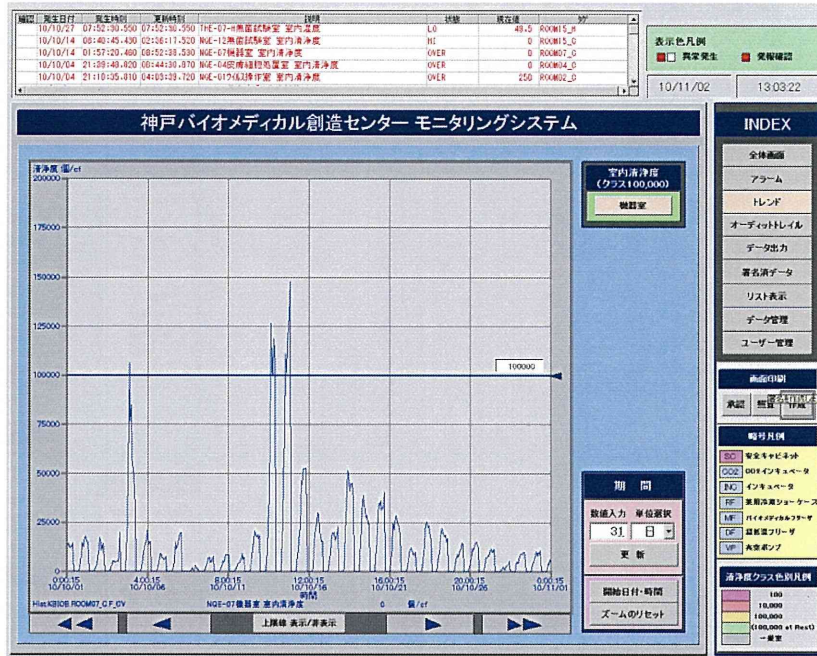

6. 分化調製室

2010年10月

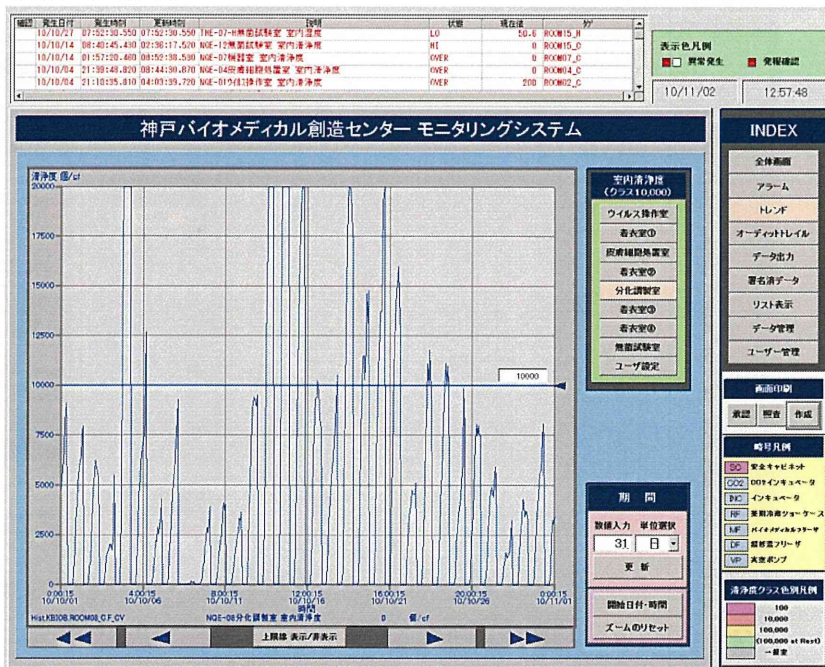


2011年3月




7. 皮膚細胞処置室

2010年10月

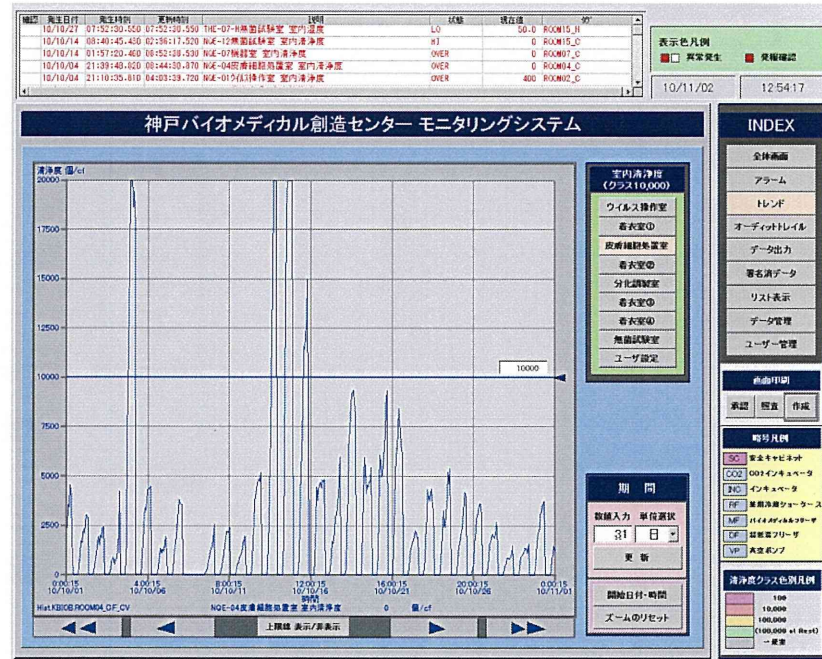


2011年3月

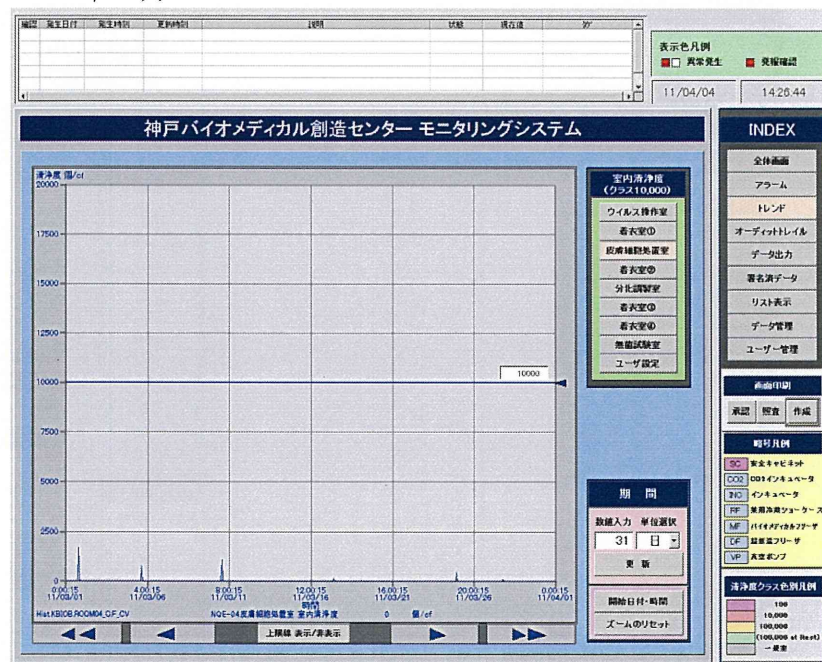

8. 着衣室③

2010年10月

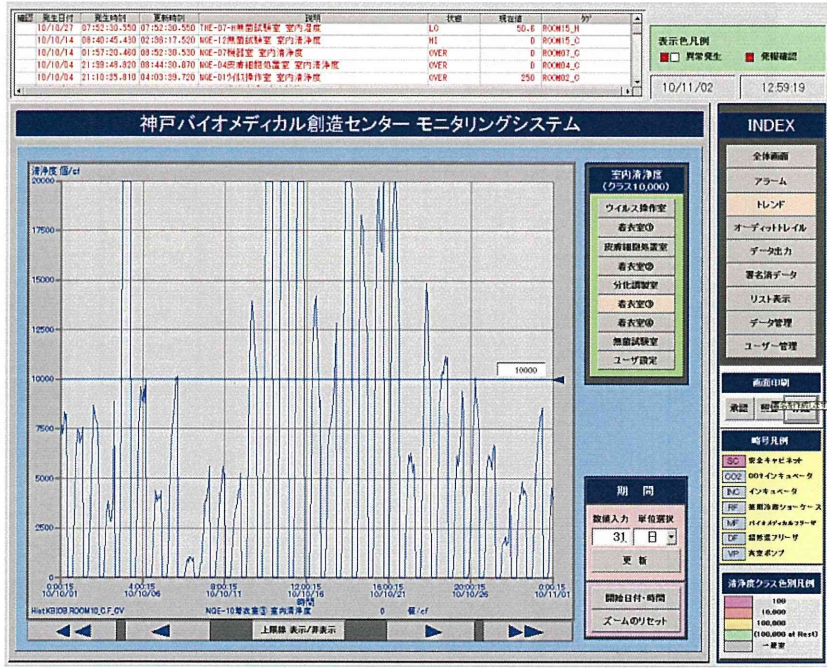


2011年3月



9. 着衣室④

2010年10月

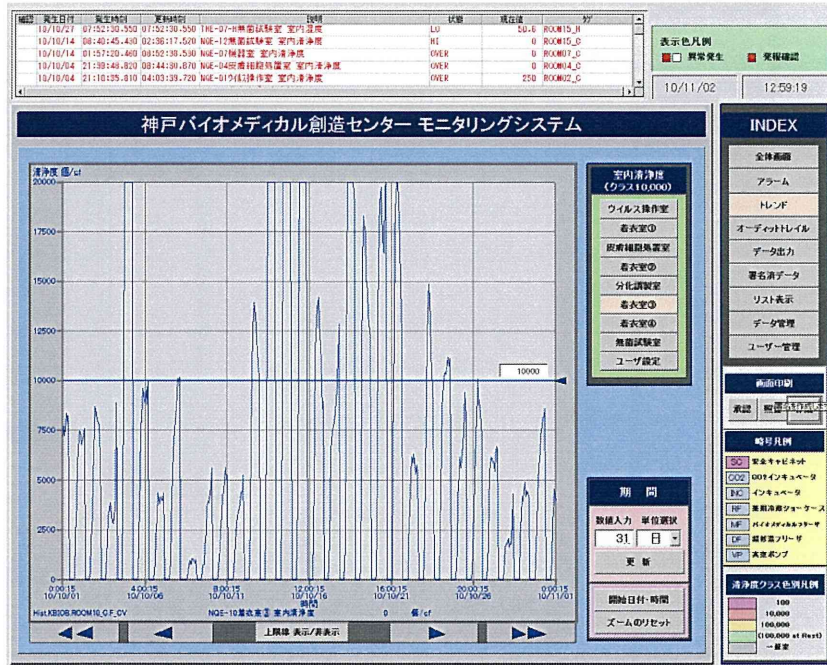


2011年3月



10. 無菌試験室

2010年10月

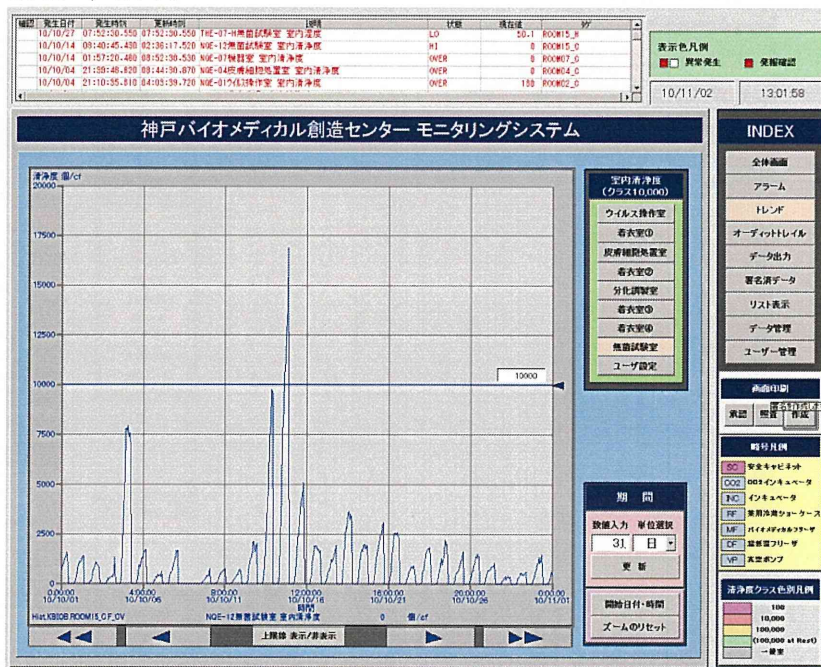


2011年3月




安キャビ清浄度

1. ウィルス操作室①

2010年10月

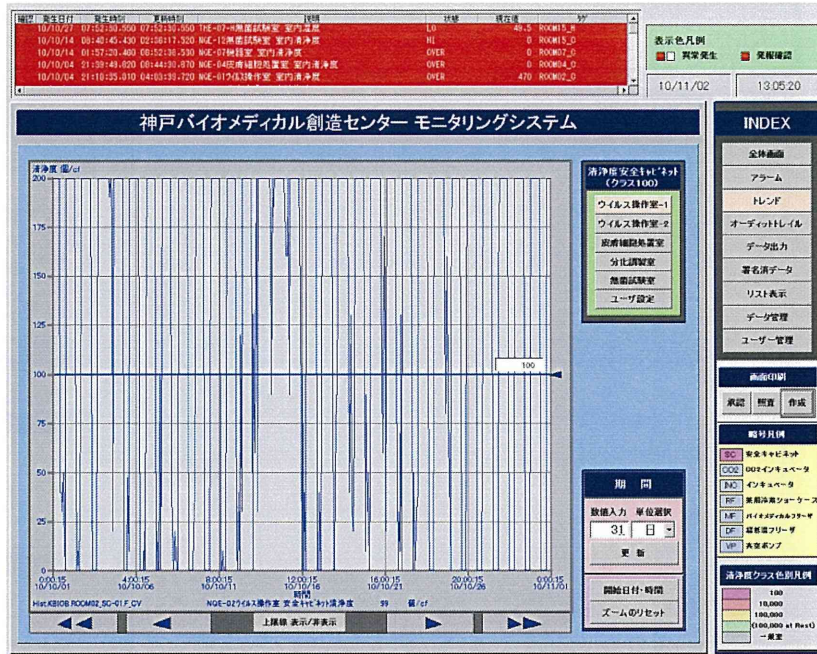

2011年3月

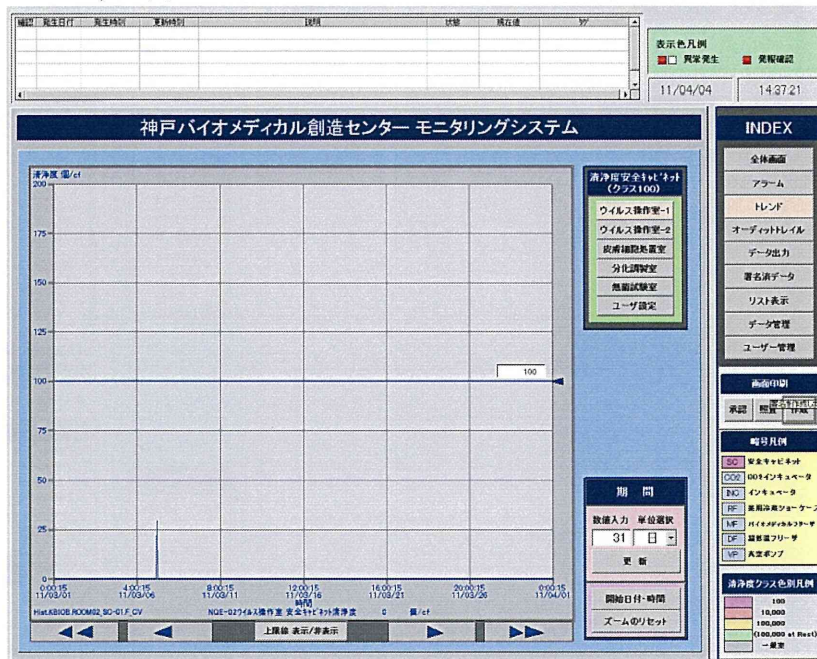

2. ウィルス操作室②

2010年10月




2011年3月




3. 皮膚細胞処置室

2010年10月

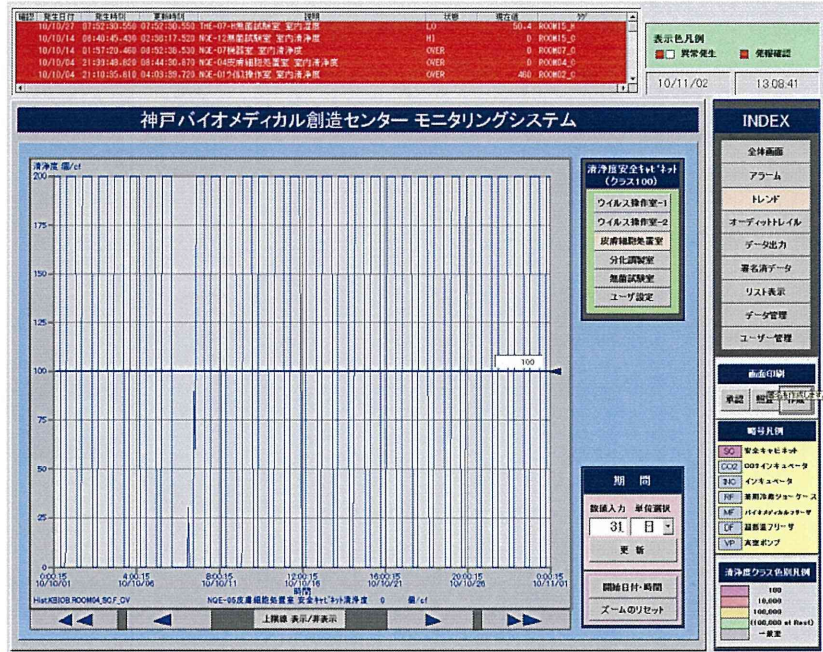


2011年3月

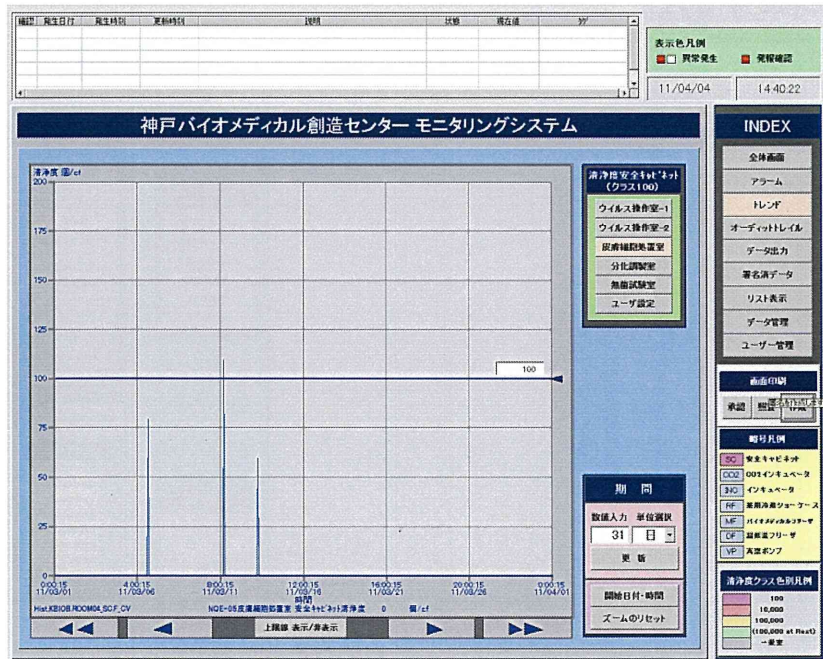

4. 分化調製室

2010年10月

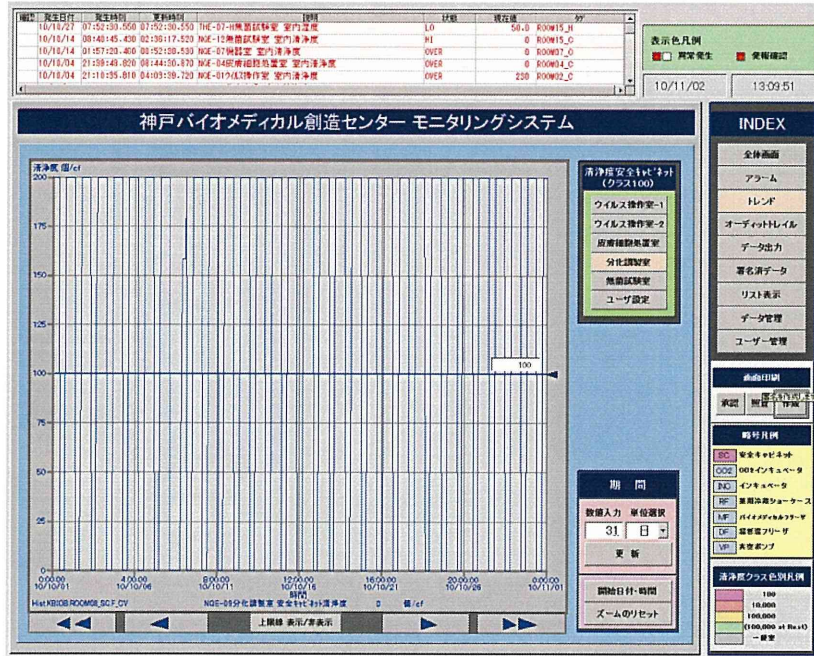


2011年3月



5. 無菌試験室

2010年10月

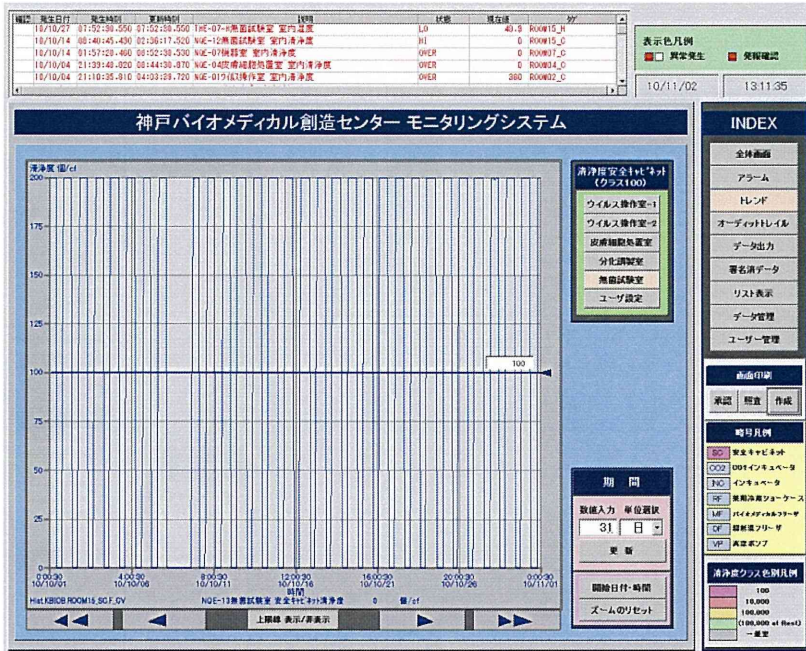

2011年3月



C02 インキュベーター (温度、C02 濃度)

1. ウィルス操作室 INC①

2010年10月



2011年3月



2. ウィルス操作室 INC②

2010年10月



2011年3月



3. ウィルス操作室 INC③

2010年10月



2011年3月



4. ウィルス操作室 INC④

2010年10月




2011年3月




5. 皮膚細胞処置室 INC⑤

2010年10月

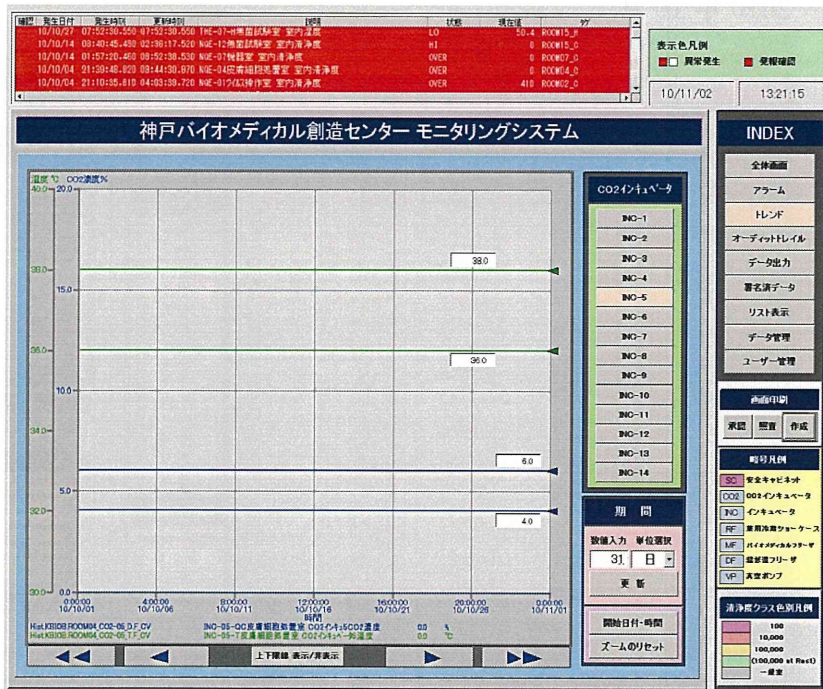

2011年3月

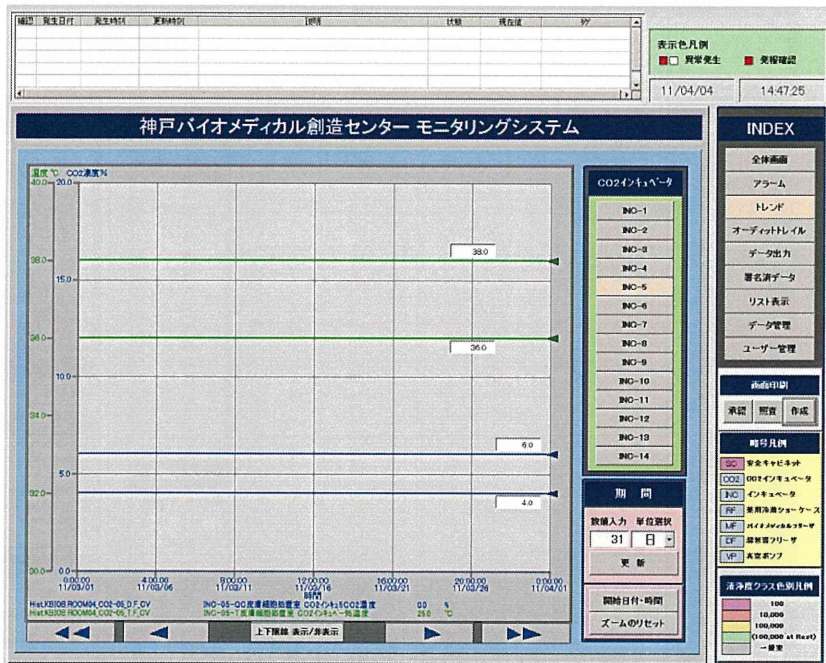


6. 皮膚細胞処置室 INC⑥

2010年10月



2011年3月

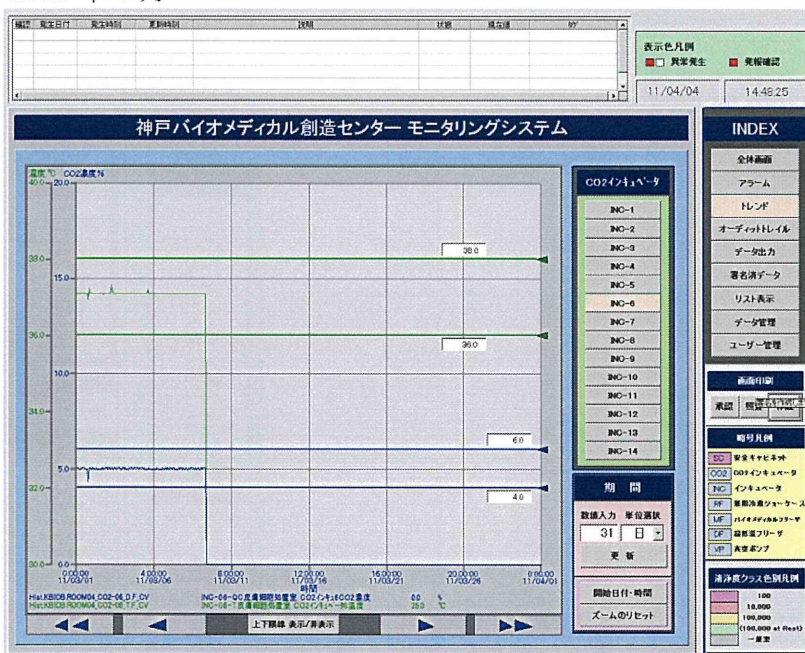

7. 皮膚細胞処置室 INC⑦

2010年10月



2011年3月



8. 皮膚細胞処置室 INC⑧

2010年10月



2011年3月



9. 分化調製室 INC⑨

2010年10月



2011年3月

