

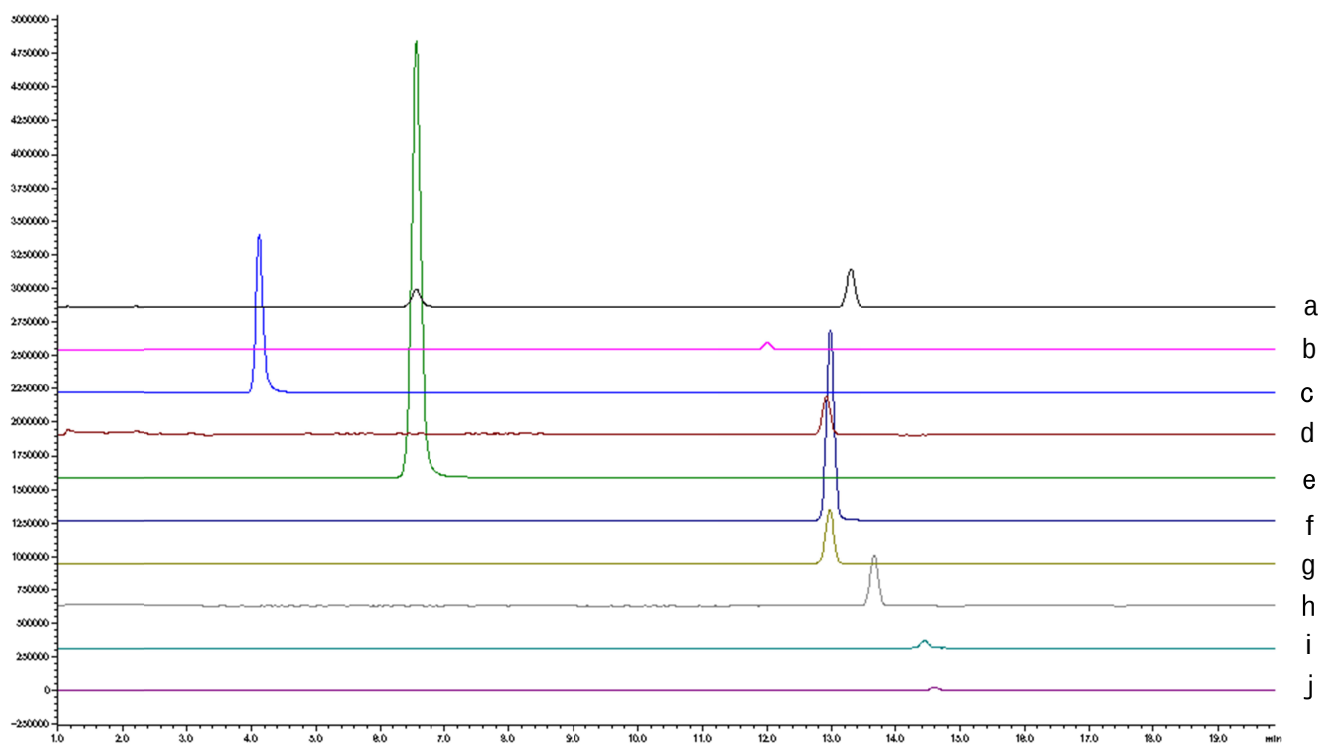


図1 標準溶液(0.01 µg/mL)のSRM クロマトグラム

使用機器：LCMS-8050 システム（島津製作所株）

- (a) アマンタジン、(b) アルビドール、(c) リバビリン、(d) リマンタジン、
 (e) アシクロビル、(f) イミキモド、(g) オセルタミビル、(h) ペラミビル、
 (i) ラニナミビル、(j) ザナミビル

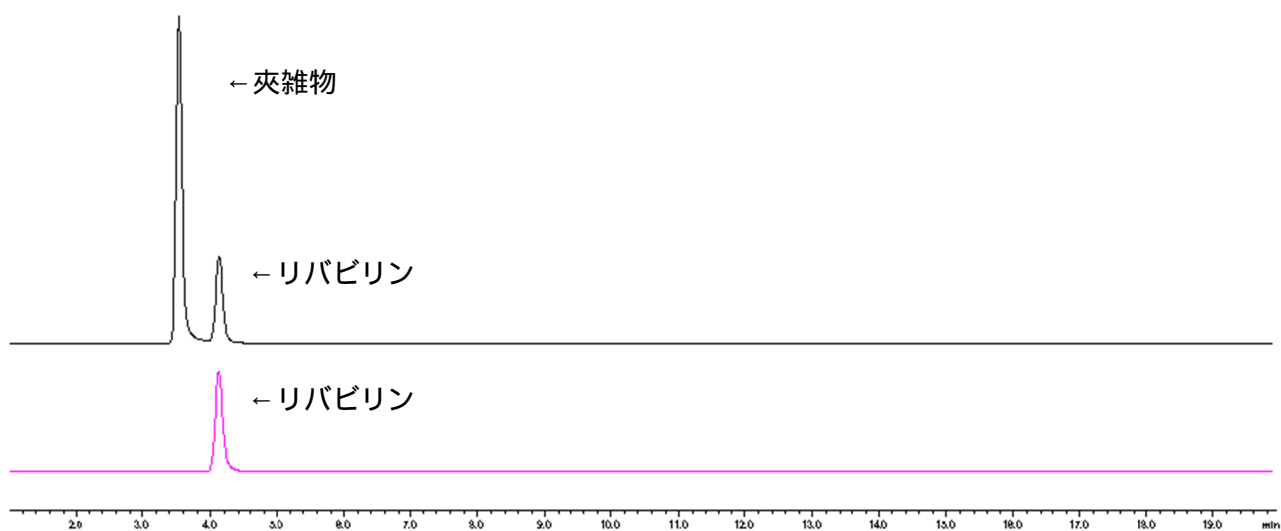


図2 リバビリンの SRM クロマトグラム
使用機器：LCMS-8050 システム（島津製作所株）