

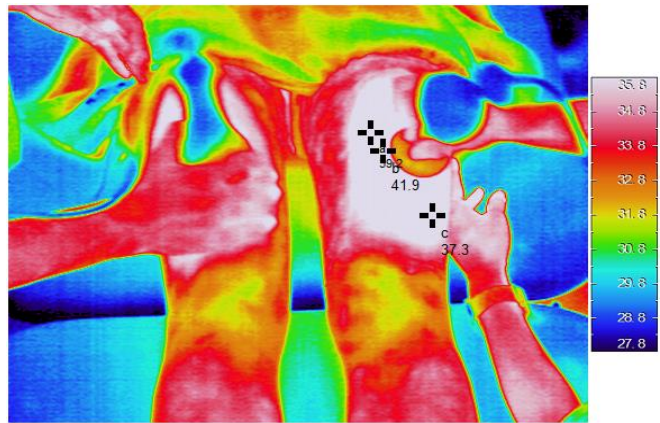
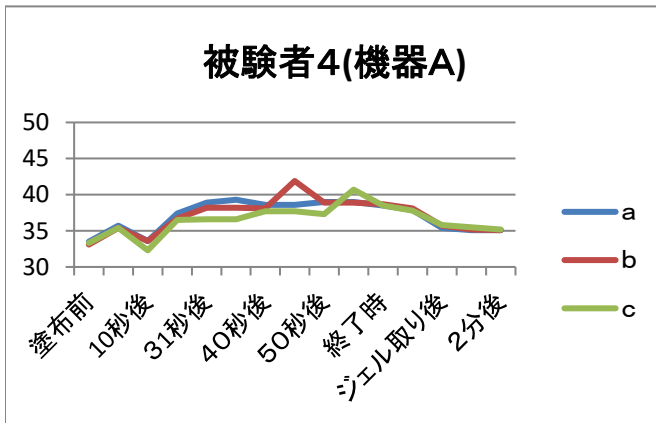
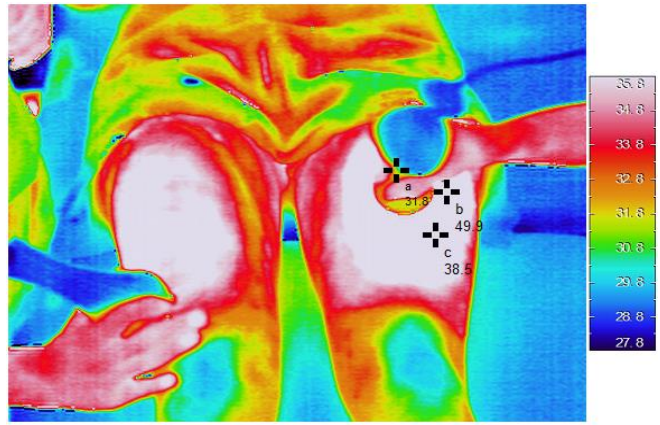
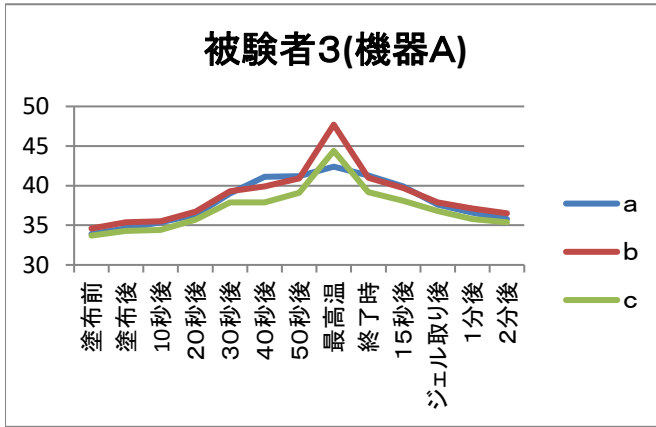
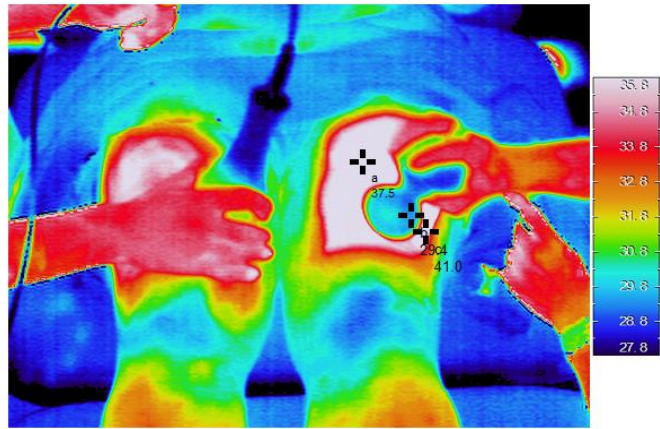
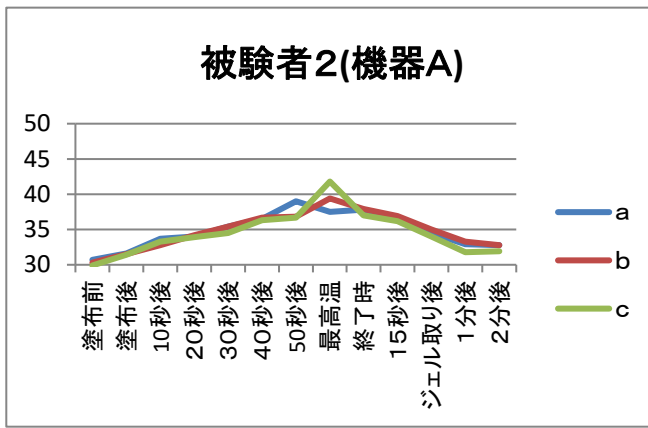
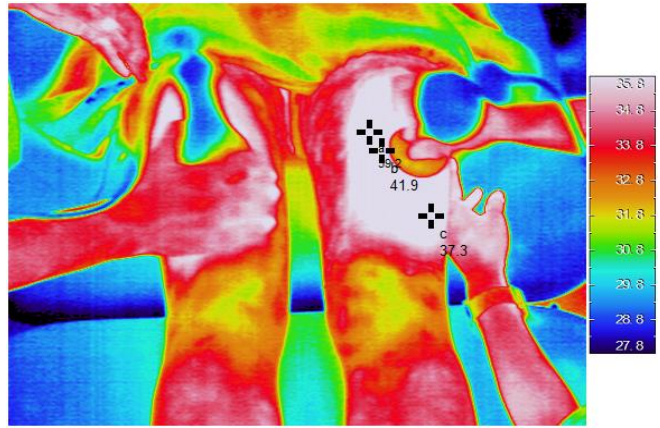
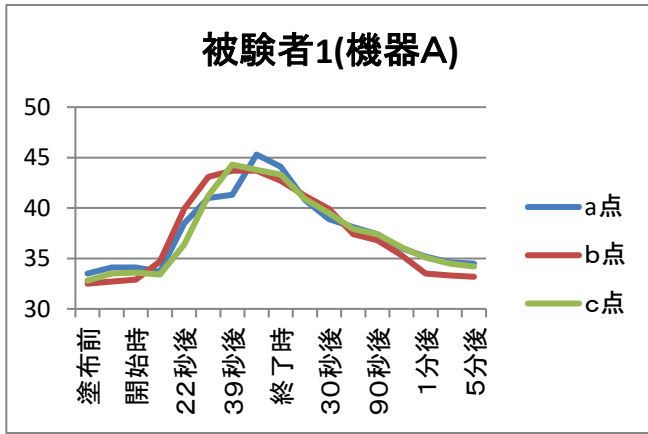




RF機器皮膚安全性試験結果

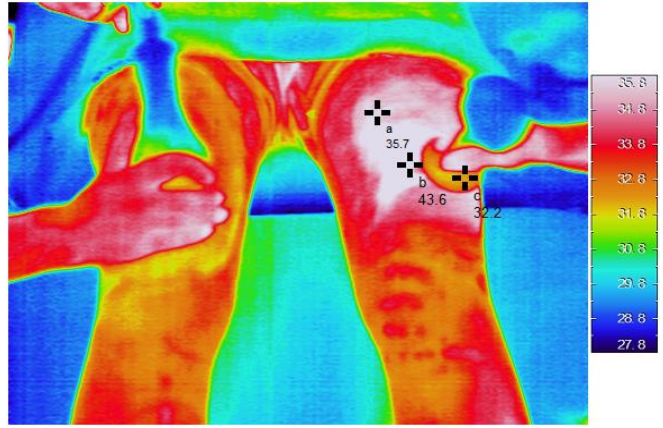



### 被験者5(機器A)

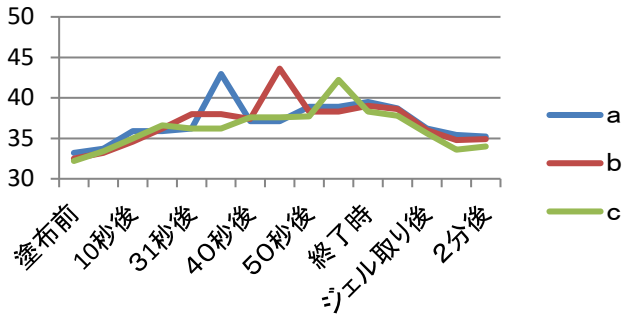



### 被験者1(機器B)

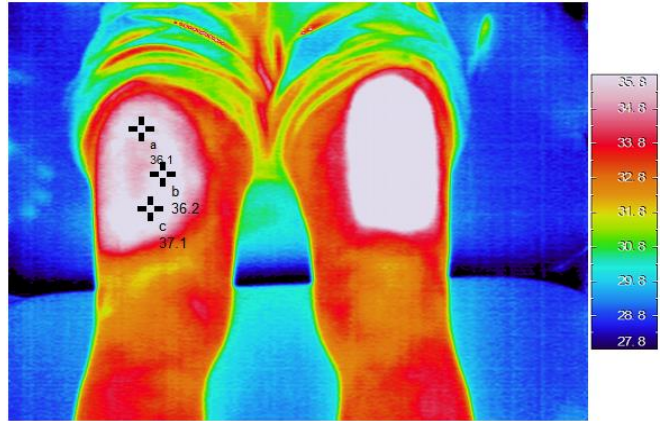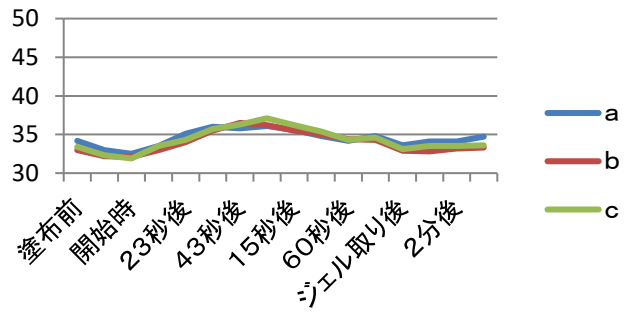



### 被験者2(機器B)

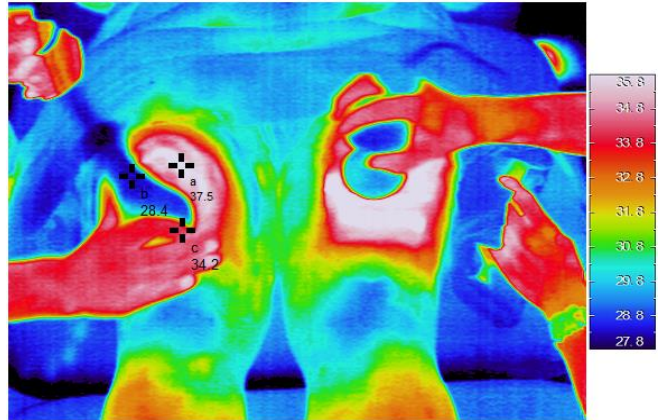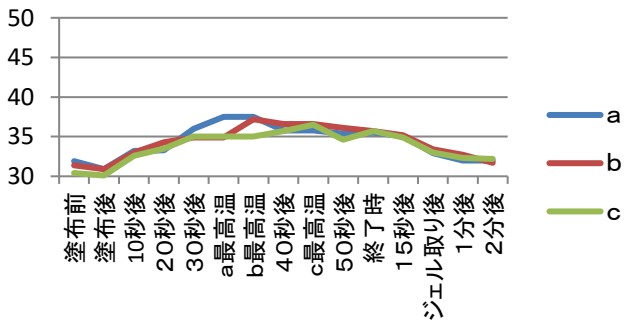



### 被験者3(機器B)

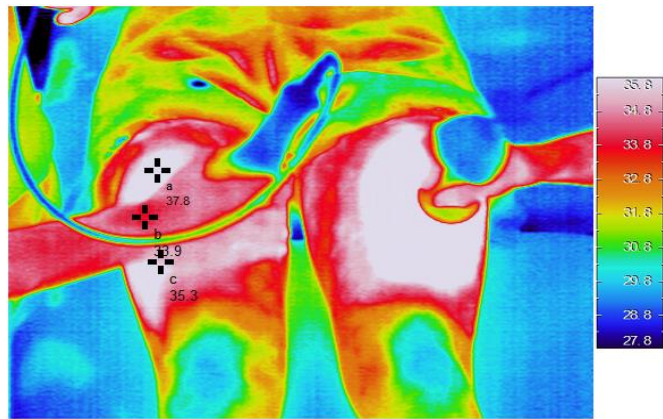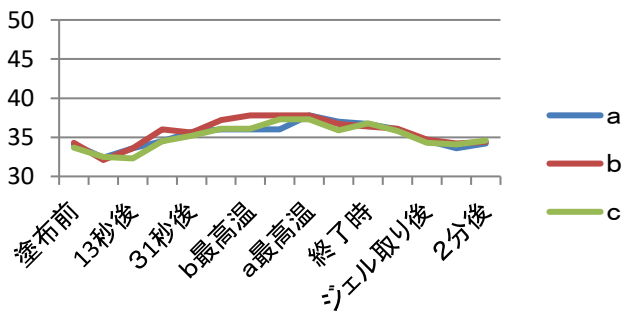


被験者4(機器B)

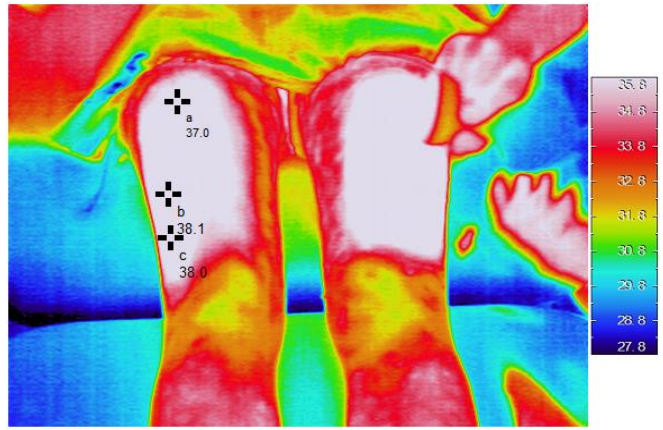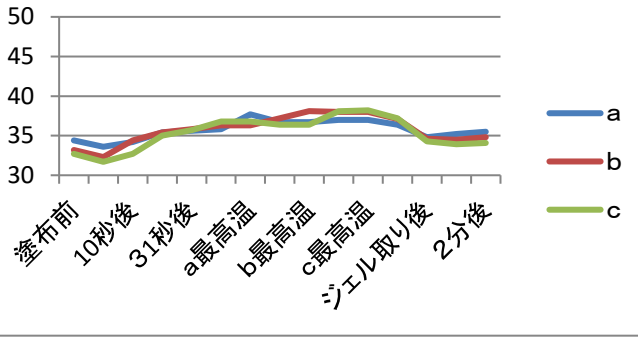


被験者5(機器B)

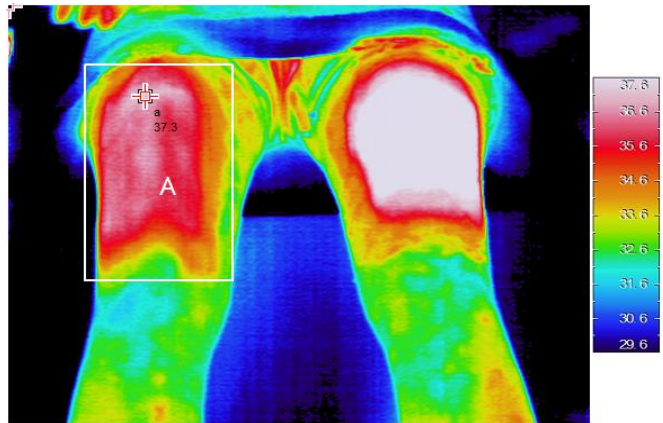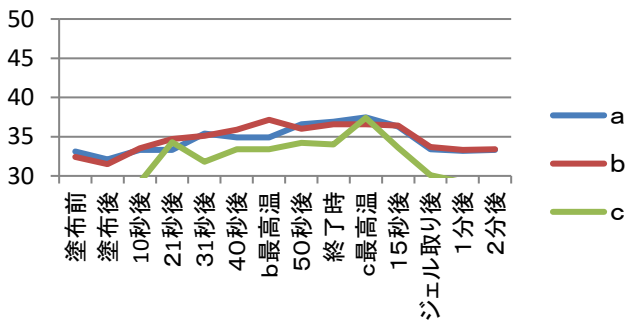


角層水分量(左大腿)

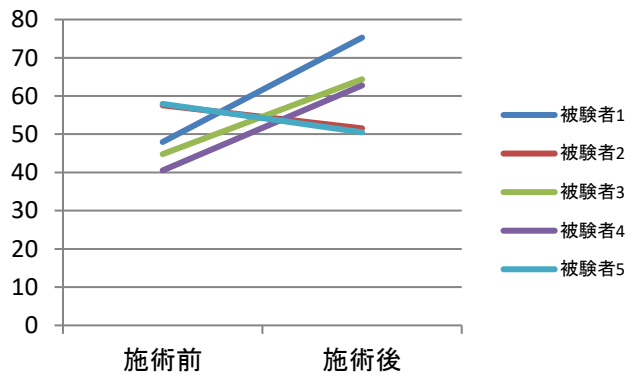

水分蒸散量(左大腿)

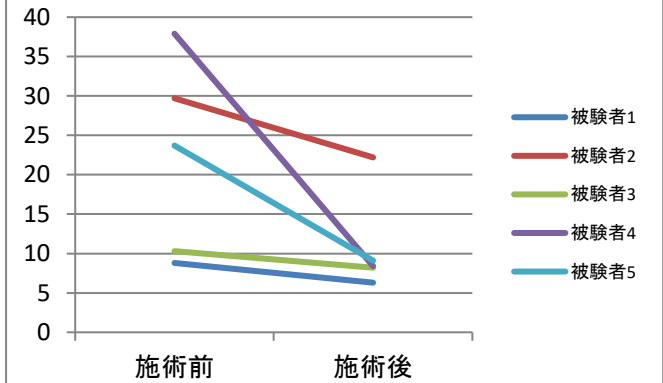

角層水分量(右大腿)

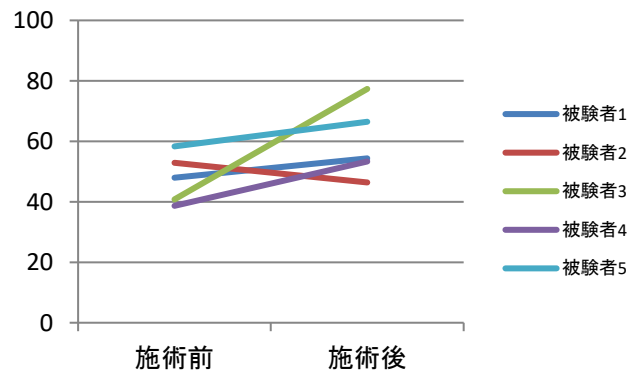

水分蒸散量(右大腿)

